

対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「SGX10 シンカリオン ドクターイエロー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。


© TOMY

© プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

〈お願い〉○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 ※セット内容以外の商品は別売です。

セット内容

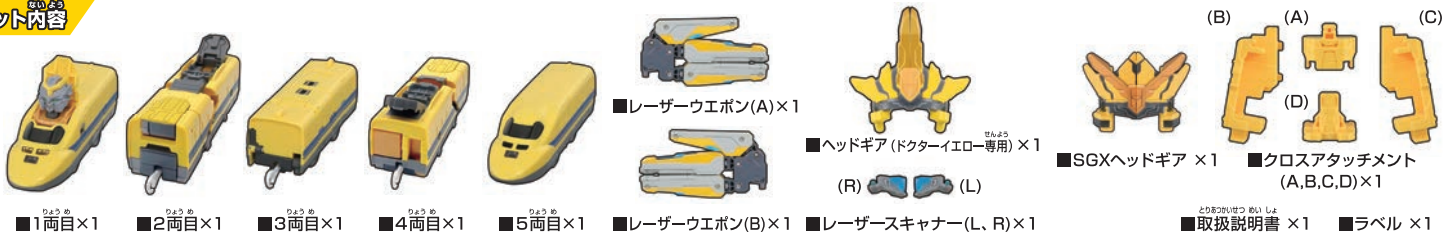

車両の見分け方



シンカンセンモードの組み立て方



シンカンセンモード完成




シンカリオンモードの変形の仕方【2両目】【4両目】



あし ひ かんりよう
脚 パーツ 準備完了

シンカリオンモードの変形の仕方【1両目】【5両目】

1 1両目を2つに分けます。

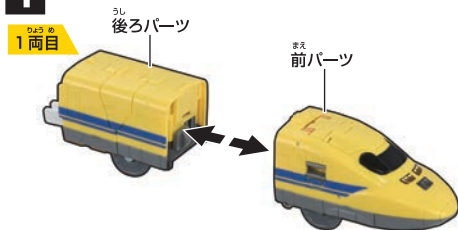

2 後ろパーツから肩を引き出します。




3 ①肩を矢印の方向へ回転させます。
②こぶしを引き出します。



※画像は右腕です。
※5両目は左腕です。右腕の1両目と同様に12目を行ってください。

4 ①ひじパーツを矢印の方向へ動かします。
②親指が前に来るようにこぶしを回転させます。

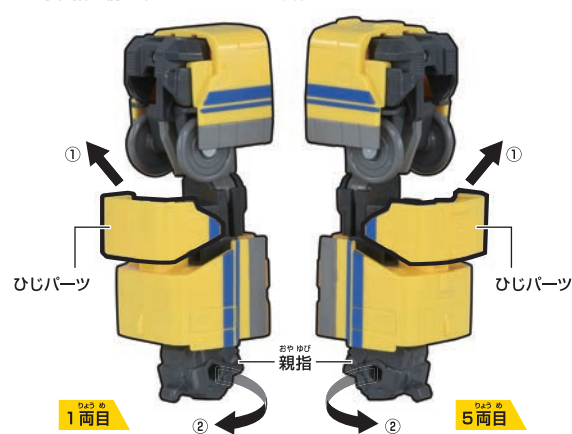

腕パーツ準備完了

各パーツの合体の仕方


1 3両目を左右に出します。




2 矢印の方向に回転させます。




3 カブラーを矢印の方向に回転させます。

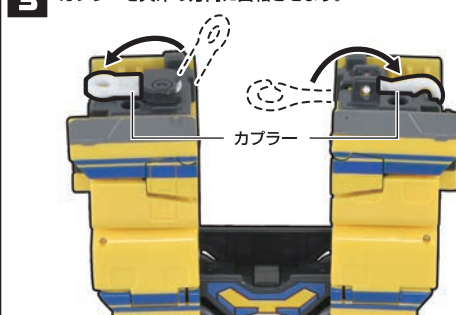


4 1両目の前パーツにラベルを貼ります。




5 ①車輪を引き出します。
②ボディを引き出します。

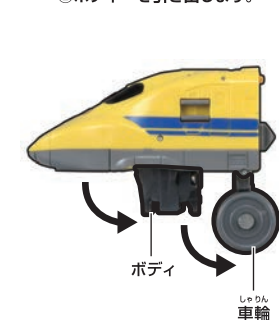


6 1両目 (前パーツ)と5両目 (後パーツ)で変形させた3両目を合体させます。

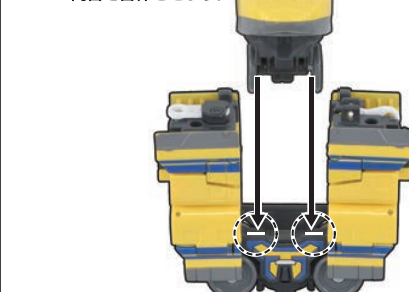

7 ①5両目の前パーツにラベルを貼ります。
②車輪を引き出します。

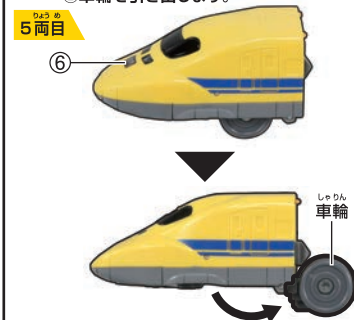


8 6で変形、合体させた3両目の後ろに5両目 (前パーツ) を取り付けます。

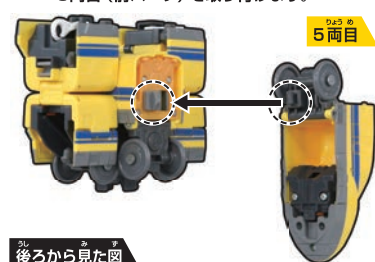

9 図のように取り付けます。




10

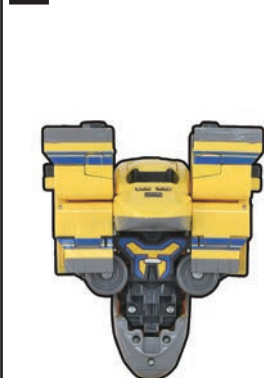


ボディパーツ準備完了

11 ボディパーツと脚パーツを合体させます。

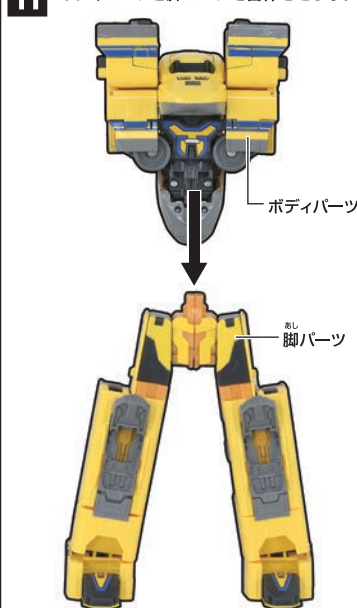


12 ラベルを貼ります。

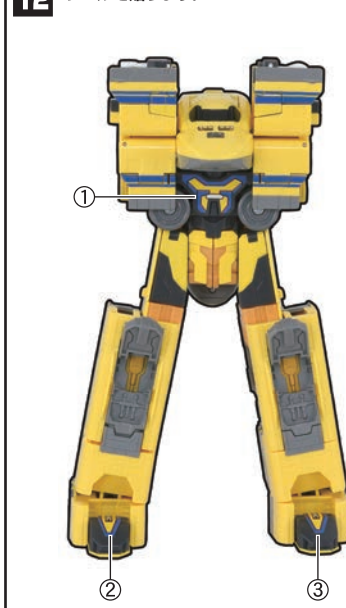


各パーツの合体の仕方

13 右腕パーツをボディパーツに合体させます。

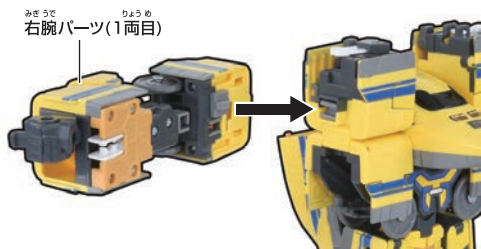


14 左腕パーツをボディパーツに合体させます。

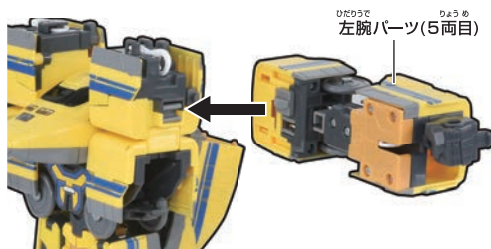


15 図のように腕を下げます。



16 ボタンを押すと頭が自動とびだします。

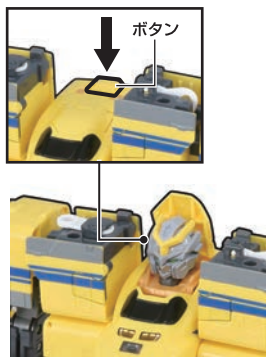

17 ①ヘッドカバーを倒します。
②補強アームを引き出します。
③★印パーツを後ろから取り付けてアームを固定します。

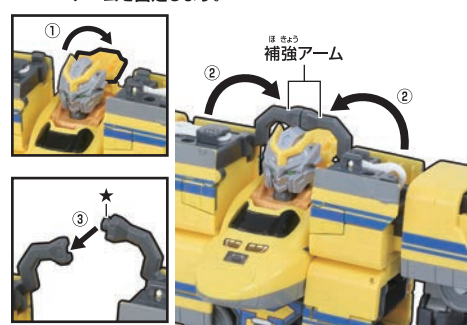


18 ①ヘッドギア (ドクターイエロー専用) とレーザーสキャナー-L,Rを組み立てます。
②頭に装着します。



19 レーザーウェポンA,Bはレーザーブラスターとレーザーソードに変形させて装着することができます。

レーザーブラスター


丸の部分をドクターイエローに持たせます。

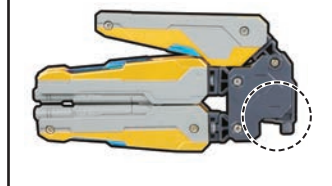

シンカリオンモード完成

※武器を持つポーズによっては、自立できない場合があります。


レーザーソード

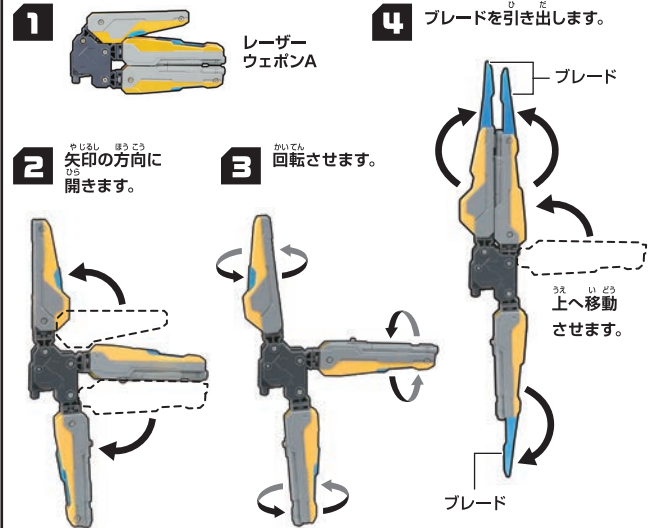


シンカンセンモードへ戻すときの注意

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。その際に下記の注意点によく注意して変形させてください。

1 各車両のジョイントの向きを変えるときはレーザーウェポンを使います。
※レーザーウェポンA,Bどちらでも使えます。

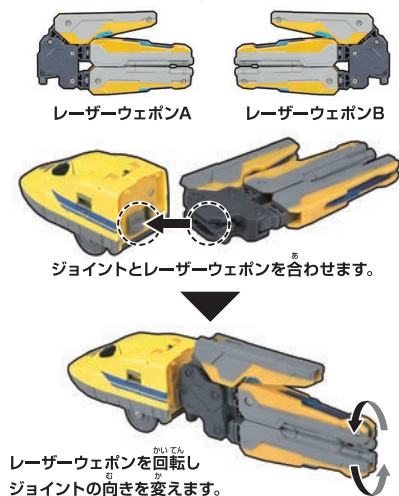


2 1両目、5両目をシンカンセンモードにするときはジョイントを縦向きに戻します。

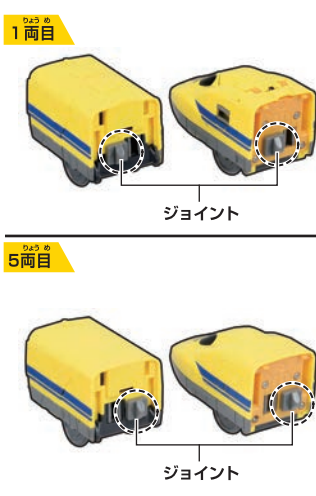

3 ジョイントの正しい向き。



4 ジョイントに合わせて合体します。

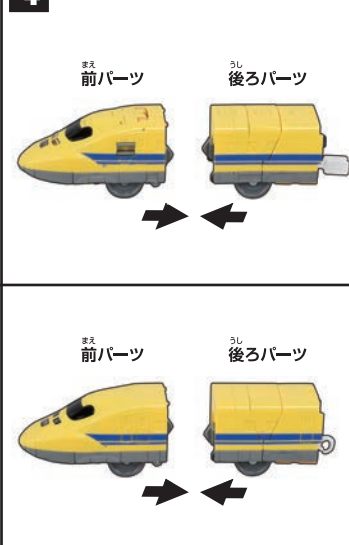


クロス合体の仕方 (E5×ドクターイエロー)

クロス合体対応
SGX商品 (別売)




※別売商品は販売が終了している場合がございます。(2026年6月現在)


SGX01 シンカリオン E5はやぶさ (別売) を使用します。

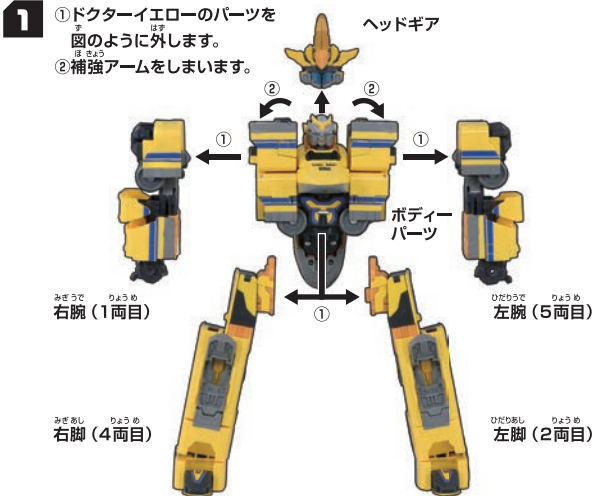


2 5両目 (前パーツ) を外します。
後ろから見た図

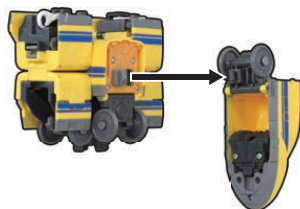

3 ①5両目のボディを引き出します。
②車輪をボディに当て
図の位置で固定します。



4 1両目 (前パーツ) を
外します。

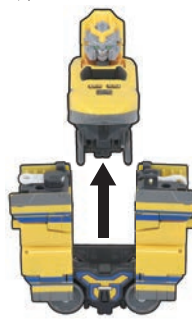


5 外した1両目 (前パーツ) を図のように
変形させます。
①ヘッドカバーを矢印の方向に倒し、
②ヘッドカバーごと頭を収納します。




※頭の角度によってヘッドカバーが閉まらないことが
あります。頭を正面に向けて収納してください。

6 ①1両目肩部分を回転させます。
②1両目 (前パーツ) と腕パーツを合体します。

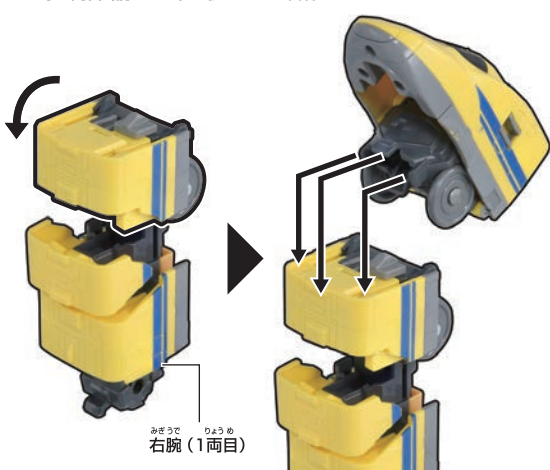




※左腕も同じように変形させます。
※画像は右腕です。

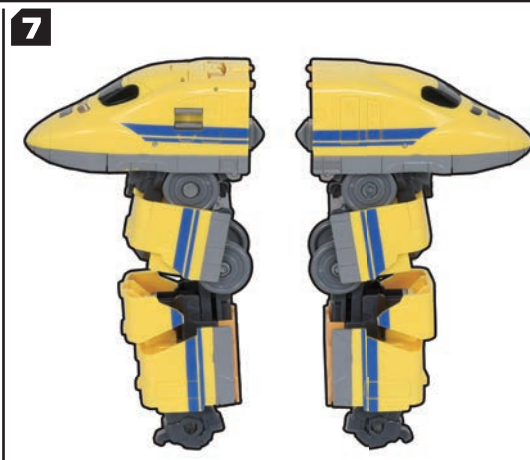

8 脚パーツを矢印の方向に引っ張り、脚のをはします。




9 ①E5はやぶさの上半身を取り外します。
②SGX01 E5はやぶさのWEB取扱説明書を参考に、図のように腕をたたみます。
③E5はやぶさのつま先を格納します。
④図のようにひざから下を後ろに曲げます。
⑤新幹線パネルを図のように回します。

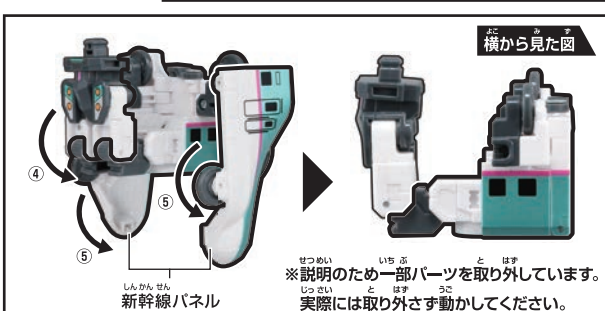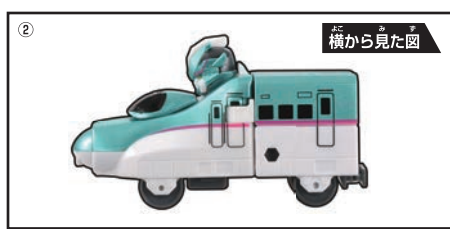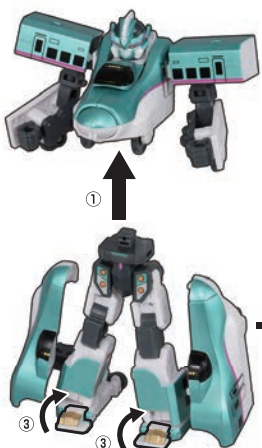


クロス合体の仕方

- 10** ①脚にクロスアタッチメントB,Cを取り付けます。
②胴体にクロスアタッチメントDを取り付けます。

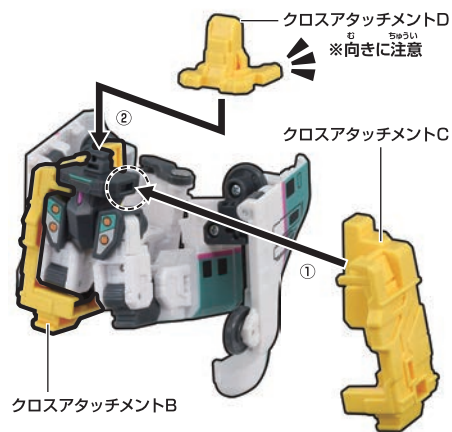

- 11** ⑩で組み立てた腰に右脚(4両目)と左脚(2両目)を取り付けます。

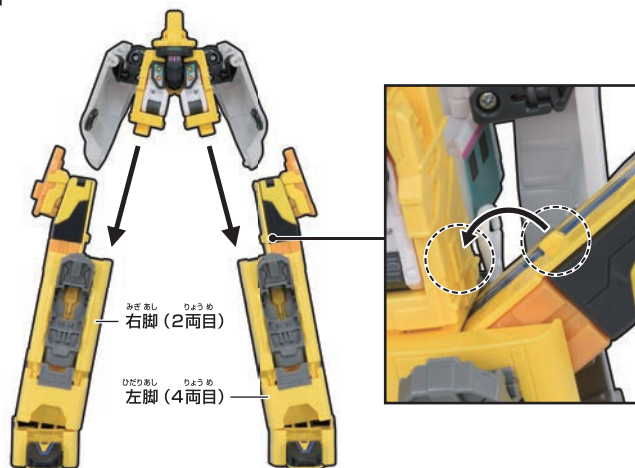


12



脚パーツ準備完了


13

- ①クロスアタッチメントAにE5はやぶさを取り付けます。
②ドクターイエローの3両目に図のように取り付けます。

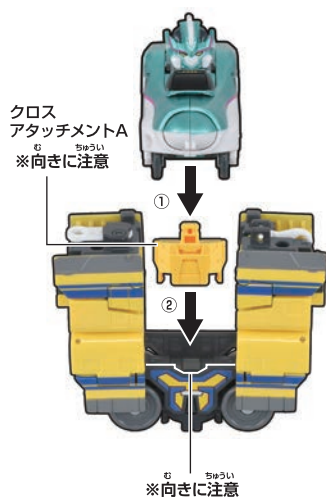


14

- ①補強アームを連結します。
②★印パーツを後ろから取り付けてアームを固定します。

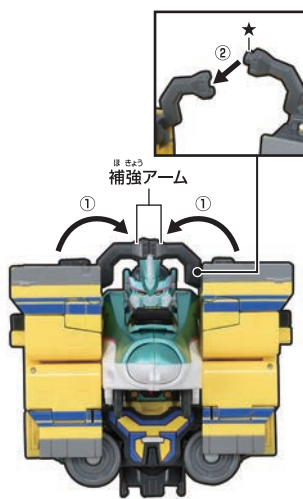



15

- 上半身と下半身を合体します。

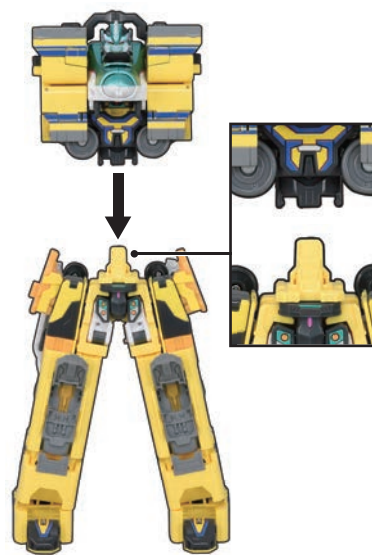



16

- ①もものつけ根を開きます。
②固定フックを引き出します。
③固定フック凸部をドクターイエローの脚パーツの穴に固定します。

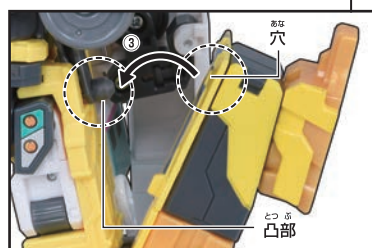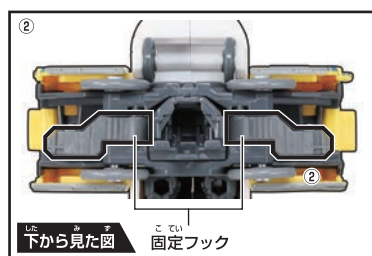

17

- 左腕パーツをボディパーツに合体します。

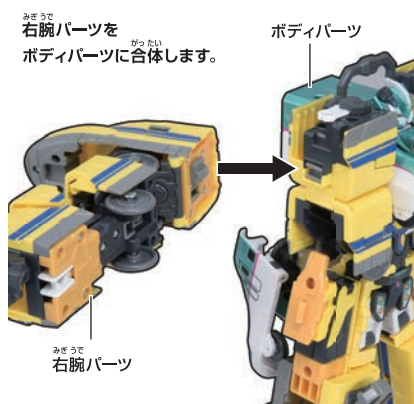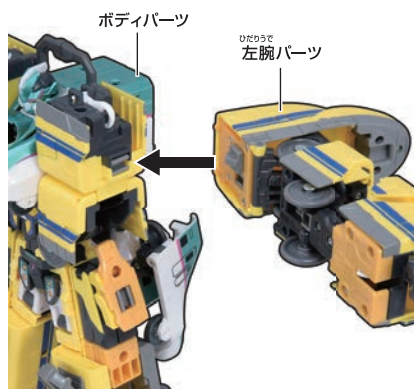


18

- 図のように腕を下げます。




クロス合体の仕方

19 レーザーウエポンを図のように広げ、ブレード、クリップを引き出します。

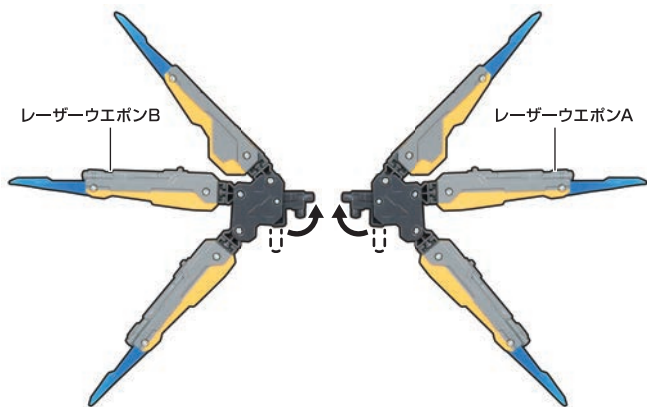

20 レーザーウエポンを
E5はやぶさの背中に装着します。

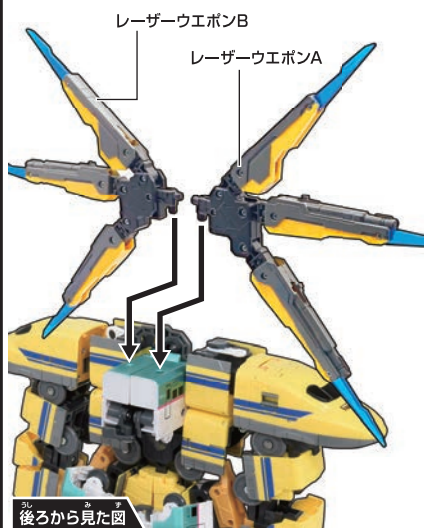


21 SGXヘッドギアの凸部を
E5はやぶさの頭の凹部に
さしこんでください。



22 ①カバーを上げます。
②カバーを下げます。
③カバーを開きます。



23 シンカリオン E5×ドクターイエロー 完成

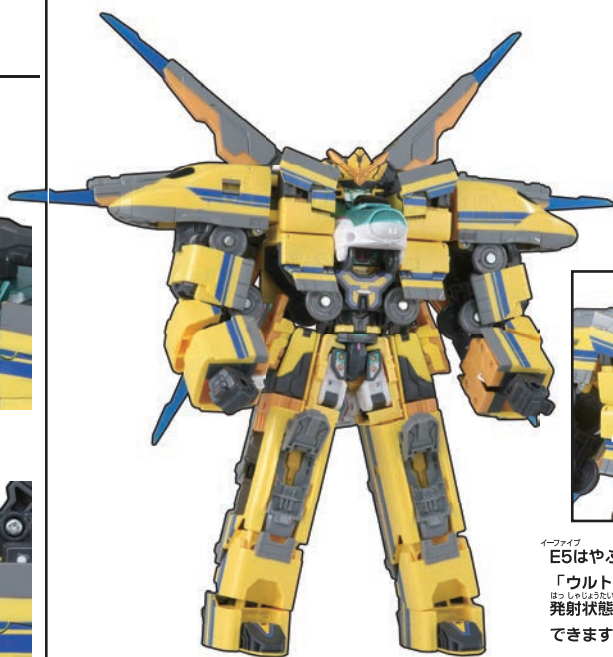


E5はやぶさのハッチを開くと
「ウルトラグランクロス」の
発射状態を再現することが
できます。

シンカリオンモードへ戻すときの注意


※シンカリオンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。その際に下記の注意点によく注意して変形させてください。

1 E5からドクターイエローの脚を外すときは図のボタンを押しながら外します。
ボタンを押さず無理に脚を外すと破損する恐れがあります。

※固定フックは
外しておいてください。

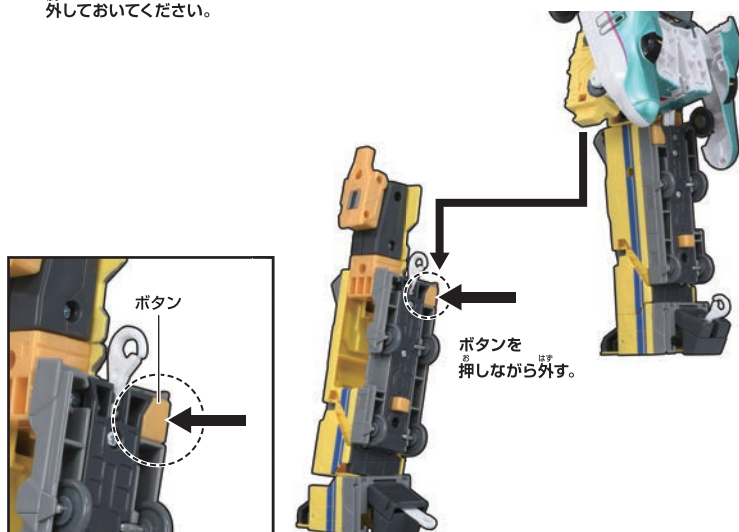

2 ①脚を縮めるときは図のボタンを押しながら縮めます。
②ボタンを押さず無理に脚を縮めると破損する恐れがあります。
※脚を縮めるときに指をはさまないように
注意してください。

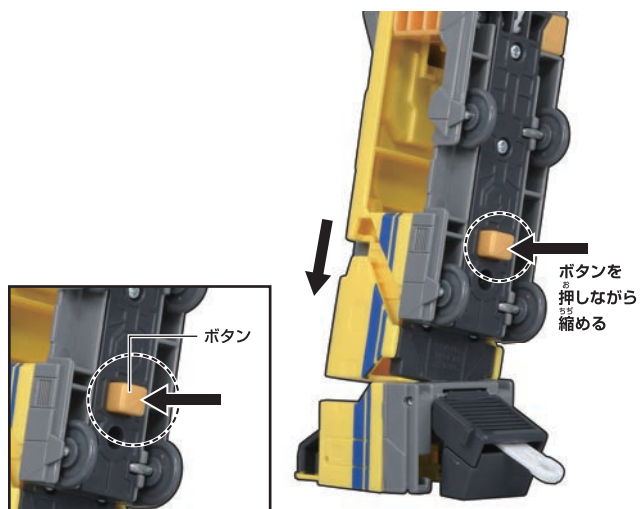

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきまは、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
（タカラトミーサポート） 検索 本製品のお客様サポートは日本国内での
ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this
product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

最新情報 日本
シンカリオン
情報をチェック!

PCからは
シンカリオンで 検索

